



Programovací schéma LIGHT MENU



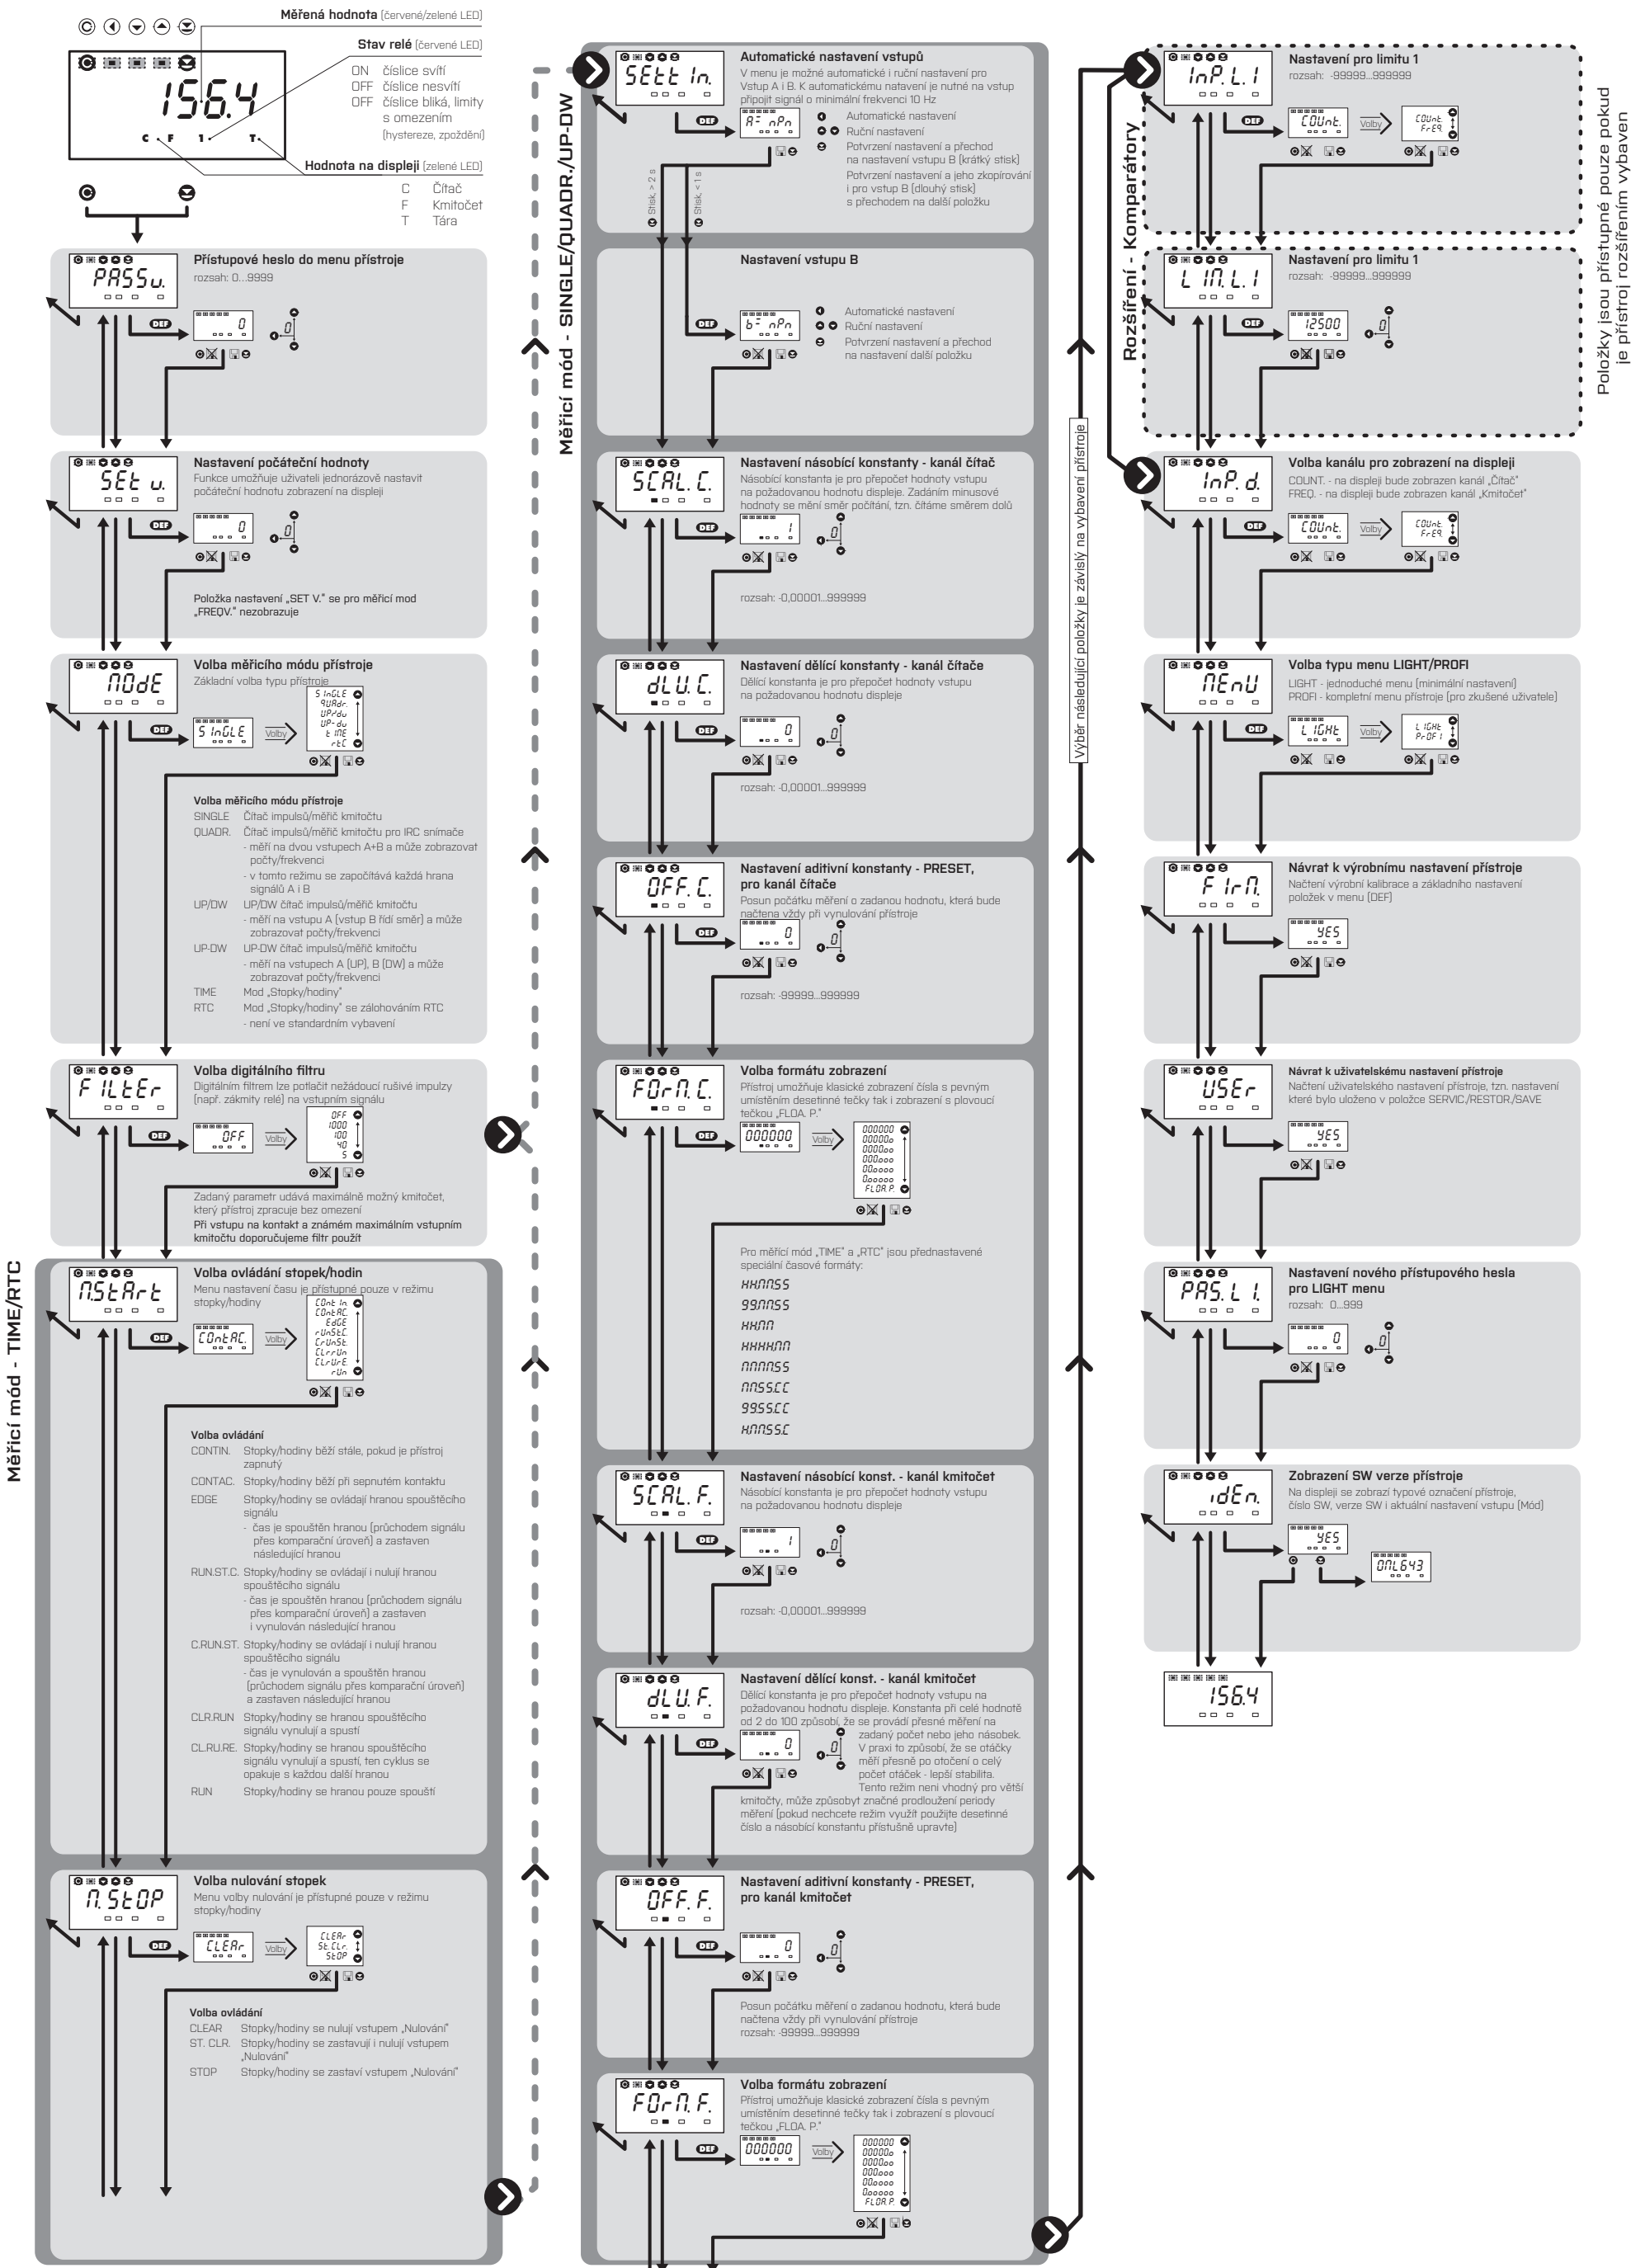

TECHNICKÁ DATA



U verze s neizolovaným napájením se vyvarujte vzniku zemních smyček!
Svorky číslo 2 a 6 jsou galvanicky spojené.

PŘESNOST PŘÍSTROJE	
TK	50 ppm/°C
Přesnost	±0,01% z rozsahu + 1 digit (kmitočet)
Časová základna	0,5/1/5/10 s
Násobící konstanta	±0,00001...999999
Dělicí konstanta	±0,00001...999999
Filtrační konstanta	umožňuje nastavit max. platný kmitočet, který je zpracován (OFF/5...1000 Hz)
Zálohování dat	uchování naměřených dat i po vypnutí přístroje [EEPROM]
Digitální filtry	exponenciální filtr, zaokrouhlení, 1/frekvence, měření na celý počet otáček (dělicí konstanta)
Funkce	Hold - zastavení měření, Lock - blokování tlačítek, Tára, Sumace - registrace směnného provozu [na kontakt]
Ovládání přístroje	magnetem (pravý dolní roh displeje) požadovanou funkci nastavíte v PROFÍ menu, položka "CONTACT" s výběrem: OFF/čítac/kmitočet/nulování/zobrazení táry/nulování táry/tára/suma/nulování sumy. Pro mód Stopky/Hodiny to je OFF/start/pauza/stop/nulování+start/nulování.
Externí vstupy	1, s možností přiřazení funkcí v menu přístroje
RTC	zálohování běhu času baterií při odpojení napájení přístroje (možno vypnout - jumper uvnitř přístroje), minimální životnost 1 rok
Baterie	Lithiový článěk CR 2032R, 3V/220 mAh
OM Link	fremní komunikační rozhraní pro nastavení, ovládání a update SW přístroje
Watch-dog	reset po 500 ms
Kalibrace	při 25°C a 40% rv.

* ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

ORBIT MERRET, spol. s r.o.
Vodňanská 675/30
198 00 Praha 9
Tel: +420 - 281 040 200
Fax: +420 - 281 040 299
e-mail: orbit@merret.cz
www.orbit.merret.cz